

## Sitteseil 25030 Barn

## Spesifikasjoner

Stoff: Nylon, Kordfløyel i bomull

Kantbånd: Polyester

Max-last: 180 kg


Størrelser: JS, JM

Vaskeråd: Se etikett på løfteseil

EAN-kod: Se [www.humancare.se/lifts](http://www.humancare.se/lifts)

Tilbehør: Brystbånd, Art. Nr. 251 45


Størrelser: 40 (Barn), 50 (Barn), 70, 80, 90, 100, 110

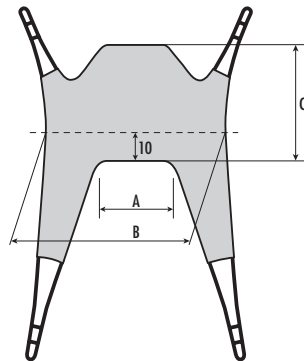

Størrelse	Fargekode	A	B	C
JS Junior, small	Lilla	9	54	52
JM Junior, medium	Hvit	15	60	58



## Sitteseil 25030 BARN

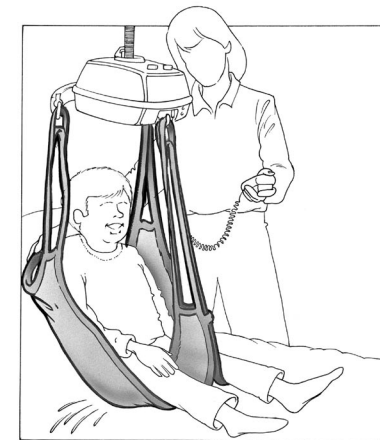

Human Cares Sitteseil 25030 er et forflyttingsseil først og fremst beregnet for forflytting mellom seng, rullestol og liknende. Seilet er stødig med forsterket ryggstøtte med to plastspiler. Sittestillingen er rett, noe som forenkler forflytting til rullestol. Seilet kan kompletteres med Human Cares Brystbånd 25145.

25030 er tilpasset for to- og trepunkts opphenging.



Human Care Norge AS, Furuveien 11, NO-2020 Skedsmokorset  
Tel 63 87 78 13 • Fax 63 87 78 17 • E-post: [post@hcn.no](mailto:post@hcn.no) • [www.hcn.no](http://www.hcn.no)

040301-040BN

**Viktig!**

⚠ Løft og forflytting av en person innebærer alltid en risiko. Les derfor nøye igjennom bruksanvisning for både løfter og løftetilbehøret. Forviss deg alltid om at det løftetilbehøret du anvender, fungerer sammen med løfteren. Som pleier/medhjelper er du ansvarlig for pleiemottagerens sikkerhet og du må kjenne til vedkommendes mulighet til å tåle løftesituasjonen. Ved usikkerhet kontakt leverandøren.

## Løft fra liggende

1.



Hvis mulig, reis opp ryggstøtten til halvt sittende. Før ned seilet bakom ryggen til høyde med halebenet. Legg merke til seilets merking (utside-opp).

*Alternativt; Legg pleiemottageren på siden. Før inn seilet slik at midten havner langs ryggraden. Rull over pleiemottageren på den andre siden og dra fram seilet.*

2.



Dra fram bendelene mellom pleiemottagerens ben. Senk ned løfteren i høyde med magen. Dersom man ønsker det, kan den venstre bendelen tres inn i hempen på utsiden av den høyre bendelen. Hekt på bendelenes løftestropper i løfterens benkrok. Vend løfteren og hekt ryggdelens løftestropper på løftegalgen. Hold løfteren unna pleiemottagerens ansikt med den ene hånden mens du kjører løfteren opp over hodet.


*Alternativ: Seilet kan også brukes med topunkts oppheng. Hempen på den høyre bendelen brukes da ikke. I stedet krysses bendelene.*

3.



Stopp i denne posisjonen og kontroller at alle løftestroppene er stramme og at de sitter på rett sted.

4.

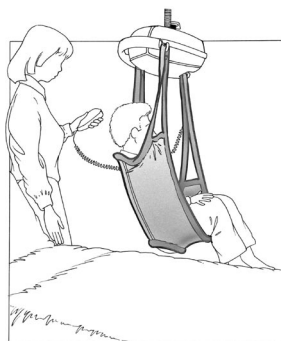

Fortsett løftet. Det kan bli nødvendig å senke sengen noe. Løft litt i pleiemottagerens ben samtidig som du vrir ham fra sengen. Hold gjerne din arm omkring pleiemottageren under forflytningen for å skape større trygghet.


## Løft fra sittende

1.



Før seilet ned bakom ryggen. Legg merke til seilets merking (utside-opp). Seilet skal ned slik at underkanten er nede ved halebenet. Dra fram seilets bendeler.

2.

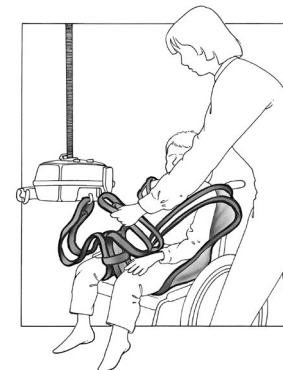

Dra seilets bendeler opp mellom pleiemottagerens ben. Senk løfteren ned i høyde med magen. Om ønskelig kan den venstre bendelen tres inn i hempen på utsiden av den høyre bendelen. Hekt bendelenes løftestropper på løfterens benkrok. Snu løfteren og hekt ryggdelens løftestropper på galgen. Hold løfteren unna pleiemottagerens ansikt med den ene hånden mens du kjører løfteren opp over hodet.

*Alternativ: Seilet kan også brukes med topunkts oppheng. Hempen på den høyre bendelen brukes da ikke. I stedet krysses bendelene.*

3.



Stopp i denne posisjonen og kontroller at alle løftestroppene er stramme og at de sitter på rett sted.

4.



Fortsett løftet. Hold gjerne din arm omkring pleiemottageren under forflytningen da det skaper en større trygghet.